

بين الأحماض الأمينية. بالإضافة إلى ذلك إذا احتاجت مشتقات الأحماض الأمينية إلى خطوة استخلاص فإن بعض الأحماض الأمينية يمكن فقدتها جزئياً. وهذا يؤدي إلى تغيير في تركيب محتوى الأحماض الأمينية وبالتالي الحصول على نتائج غير صحيحة.

المشكلة الثانية

تتمثل في المجاميع الفعالة الأخرى الموجودة في السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية فتكون الاستجابة قليلة لأحماض السيستئين، الليسين والهيدروكسي لysin. أيضا يمكن للحمض الأميني الواحد أن يعطي أكثر من Peak بدلا من Peak واحد بسبب تكون مشتقات مختلفة.

المشكلة الثالثة

تتمثل في العينة نفسها Matrix of the sample. فمن النادر ما توجد عينة تحتوى فقط على أحماض أمينية ماعدا المخلوط القياسي للأحماض الأمينية. وقد تتداخل مكونات العينة مع الجواهر المستخدمة لتقدير مشتقات الأحماض الأمينية، وبالتالي نحصل على نتائج غير دقيقة.

سابعاً: آلية فصل الأحماض الأمينية باستخدام المبادلات الأيونية

ان استخدام المبادل الكاتيوني Cation exchanger (طور ثابت) مع تغيير في درجة حموضة pH المحلول المنظم (طور متحرك) فإنه يمكن فصل مدى واسع من الأحماض الأمينية، وهذه هي الفكرة الأساسية التي يعتمد عليها جهاز تحليل الأحماض الأمينية.

وفيما يلي توضيح أكثر لكروماتوجرافيا التبادل الأيوني:-

كروماتوجرافى التبادل الأيونى Ion-exchange chromatography

يعتمد الأساس فى هذا النوع الكروماتوجرافى على الانجذاب Attraction ما بين الشحنات المتضادة فى الجزيئات، حيث تحتوى العديد من المواد الحيوية مثل الأحماض الأمينية والبروتينات على مجاميع قابلة للتأين Ionizable.

وفى الحقيقة أنها تحمل محصلة شحنات Net charge إما موجبة أو سالبة، وتستخدم فى فصل مخاليط هذه المركبات. وتعتمد محصلة الشحنات لهذه المركبات على درجة حموضة محلول الوسط pH وكذلك على نقطة التعادل الكهربى للمركب. ويوجد نوعان من المبادلات الأيونية:

مبادل كاتيوني Cation ومبادل انيوني Anion.

تحمل المبادلات الكاتيونية مجاميع محملة بشحنات سالبة، وبالتالي تتجذب الى الجزيئات المحملة بشحنة موجبة. ويطلق فى بعض الأحيان على هذه المبادلات اسم المواد المبادلة للأيونات الحمضية - Acidic ion exchange materials، حيث أن الشحنات السالبة لها تنتج من تأين المجموعات الحمضية. تنجذب المبادلات الأنيونية التى تحتوى على شحنات موجبة إلى الجزيئات المحملة بشحنة سالبة. ويستخدم اصطلاح المواد المبادلة للأيونات القاعدية Basic ion exchange materials حيث أن الشحنات الموجبة ناتجة من تأين المجموعات القاعدية.

نوع المبادل	المجاميع الفعالة	صفة التأين للمبادل	المبادل
مبادل أيونى حمضى	حامضية	سالب	كاتيونى
مبادل أيونى قاعدى	قاعدية	موجب	انيونى

توضع المبادلات الأيونية فى أعمدة لفصل مخاليط أيونية. وفى حالة وجود طور متحرك يحتوى على أيونات العينة الذى يمر خلال عمود يحتوى على مبادل أيونى فيحدث توزيع تنافسى للأيونات ما بين المبادل الأيونى والطور المتحرك ويعتمد معدل تحرك الأيونات خلال العمود على تألفها النسبى Relative affinity، ويعتمد وقت الظهور R_f فى التحليل التى تعتمد على المبادل الأيونى على عدة عوامل تشمل:-

- ١- حجم ونوع الشحنة فى أيونات العينة.
- ٢- درجة حموضة pH الطور المتحرك.
- ٣- التركيز الكلى ونوع الأيونات فى الطور المتحرك.
- ٤- وجود مذيبات عضوية مثل الميثانول فى الطور المتحرك.
- ٥- درجة حرارة العمود (درجة حرارة الأطوار الثابتة والمتحركة).
- ٦- معدل سريان الطور المتحرك.

والجدير بالذكر أن خاصيتى الأدمصاص والتوزيع تلعب دورا جزيئا Some Part فى الفصل باستخدام أعمدة المبادلات الأيونية. ولهذا فمن الصعب التنبؤ بسلوك أعمدة المتبادلات الأيونية فى بعض التحليلات، على العكس من الكروماتوجرافى السائل.


وتتم آلية التبادل الأيونى عن طريق خمس نقاط واضحة وهى:-

- ١- الانتشار الأيونى إلى سطح المتبادل. وتحدث هذه العملية بسرعة فى المحاليل المتجانسة.
- ٢- الانتشار الأيونى خلال تركيب جسم الـ Matrix المبادل إلى مواقع التبادل Exchange sit. وتعتمد هذه الخطوة على مدى الروابط العرضية


Cross linkage للمبادل وتركيز المحلول وهذه العملية هي أساس التحكم في مدى عملية التبادل الأيوني الكاملة بذاتها.

٣- تبادل الأيونات عند موقع التبادل، تحدث هذه العملية في الحال -Instantaneously ويتم خلالها الإتزان.

Cation exchanger:



Anion exchanger:



٤ - انتشار الأيون الذي تم مبادلته Exchanged خلال المتبادل إلى السطح.


٥ - الذوبان الاختياري Selective desorption بواسطة المذيب ثم انتشاره إلى المحلول الخارجى. وتعتمد عملية الذوبان الاختياري للجزء المرتبط على التغيرات في درجة حموضة الوسط والتركيز الأيوني أو بواسطة تآلف الاستخلاص Affinity elution.

٧-١- تحضير مواد التبادل الأيوني

توجد عدة مواد مبادلة للأيونات Ion-Exchanger تجارياً تستخدم بنجاح في فصل المواد الحيوية. وتحضر هذه المواد من الأستيرين مع ثنائى فينايل البنزين. ومركب عديد الأستيرين هو مركب عديد البلمرة، جزيئاته مرتبة في خط مستقيم Linear polymer ويذوب في العديد من المذيبات ويتكون نتيجة لتكثف الأستيرين مع ثنائى فينايل البنزين، جزيئات لها روابط عرضية هي التي تجعل الراتنج غير ذائب.

وتعتمد درجة تكوين الروابط العرضية Cross linkage على النسب المختلفة من ثنائي فينايل بنزين والأستيرين فإذا كانت نسبة المكون الأول أعلى من الأستيرين فإنه يعطى مركب له روابط عرضية عالية.

والراتنجات ذات الروابط العرضية القليلة تسمح بنفاذ Permeable الجزيئات ذات الوزن الجزيء الكبير عن الراتنجات ذات الروابط العرضية الكثيرة. وعند اجراء السلفنة Sulphonation للروابط العرضية لعديد الأستيرين فإنه يعطى راتنج مسلفن Sulphonated polystyrene مثل Dowex 50 الذى هو متبادل حمضى قوى حيث تتأين مجموعة السلفونيك ($-SO_3H$) على مدى واسع من درجة الحموضة pH ماعدا درجة الحموضة المنخفضة جداً. ويحضر المبادل القاعدى القوى عن طريق تفاعل الروابط العرضية مع كلوروميثيل إيثر ثم تفاعل مجاميع الكلورو مع أمينات ثلاثية. والمجموعات $CH_2-N^+(CH_3)_3$ Cl^- تتأين على درجات حموضة واسعة ماعدا درجة حموضة وسط عالية. وتمتاز جميع المواد المبادلة بأن لها سعة تبادلية كلية Total exchange capacity محددة، والتي تعرف بأنها عدد ملليمكافئات الأيونات القابلة للتبادل لكل جرام من المبادل أو لكل وحدة حجم من الراتنج الممتزج بالماء Hydrated resin وعلى ذلك فالسعة التبادلية للراتنج Bio-rad. AG-x4 تساوى ١,٢ ملليمكافىء لكل سم^٣ وللمبادل DEAE- sephadex A2 له سعة تبادلية تساوى ٠,٥ ملليمكافىء لكل سم^٣ وفى بعض الأحيان يستخدم اصطلاح السعة المتاحة Available capacity للدلالة على السعة المتاحة لمركب معين مثل الهيموجلوبين، فالراتنج DEAE-sephadex A25 له سعة متاحة للهيموجلوبين تقدر بـ ٠,٠٧ جم/ سم^٣ وتدل السعات التبادلية على درجة الاستبدال للراتنج، ومن ثم تعطى وسيلة ارشادية على مدى مجال الاستخدام. ومن ذلك يتضح أن الراتنجات تختلف فيما بينهما تبعاً:

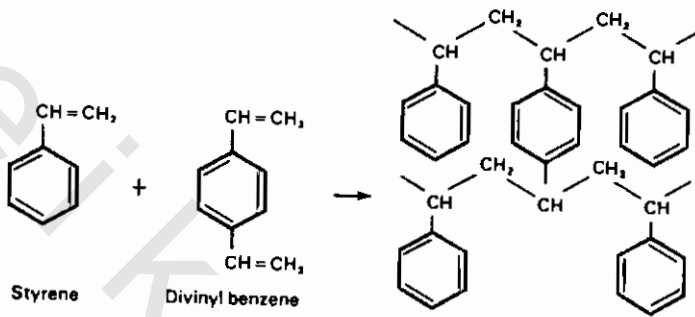


Co- polymerization of styrene and divinylbenzene.

١- حجم الجسيم Matrix

٢- درجة الروابط العرضية.

٣- درجة السلفنة.

يبدأ العمود بجزيئات صلبة من مادة سلفونات عديدة الأستيرين Sulpho-nate poly styrene سبق اتزانها Equilibrated مع محلول صودا كاوية. وفي هذه الحالة نجد أن مجموعات حمض السلفونيك تكون محملة كاملاً بكاتيون الصوديوم (Na⁺). وهذه الصورة من الراتنج تعرف باسم الصورة الصوديومية Sodium form. ويمكن تحضير الراتنج في الصورة الهيدروجينية Hydrogen form عند غسيله بحمض. وتحدث عملية التبادل للأحماض الأمينية كما في المعادلات التالية:

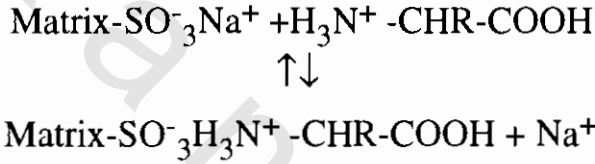

ومن ذلك يتضح أن فصل الأحماض الأمينية يعتمد بصفة عامة على:

١- إختلاف شحنات الأحماض الأمينية والذي يعتمد على قيم ثوابت الانقسام (pK) للسلاسل الجانبية (R).


٢- تفاعل السلاسل الجانبية الكارهة للماء الخاصة بالمبادل الأيوني عديد الأستيرين مع الأحماض الأمينية. يضاف محلول حمضى (pH=3.0) من خليط الأحماض الأمينية إلى الراتنج في الصورة الصوديومية. وعند درجة الحموضة هذه فإن جميع الأحماض الأمينية تحمل شحنة موجبة، أى لا يحدث تبادل أيونى أو ارتباط، فى حين تميل الأحماض الأمينية الكاتيونية Cation amino acids إلى أن تحل محل بعض أيونات

الصوديوم الموجودة في جزيئات الراتنج. وأن كمية الإحلال Displace-ment تختلف بدرجة قليلة Slightly بين الأحماض الأمينية المختلفة نظراً للاختلافات في درجة التأيين.


فعند درجة حموضة ٣ فإن أغلب الأحماض الأمينية القاعدية (ليسين- أرجنين- هستدين) ترتبط بقوة مع الراتنج بواسطة قوى الكترولستاتيكية، وتستخلص عند درجة حموضة ٩-١١. بينما أغلب الأحماض الأمينية الحمضية (جلوتاميك- أسبارتيك) ترتبط بقوة ضعيفة فيحدث إحلال لها أولاً ثم يتبعها الأحماض الأمينية المتعادلة مثل الجليسين والفالين.

وحيث أن درجة حموضة محلول الإحلال Eluting solution ترتفع تدريجياً وكذلك تركيز كلوريد الصوديوم، فإن الأحماض الأمينية تتحرك إلى أسفل العمود بمعدلات مختلفة بحيث تكون في المقدمة الأحماض الأمينية الحمضية ثم المتعادلة ثم القاعدية. ويمكن جمعها على هيئة أجزاء صغيرة كثيرة Many small fractions والتي يجرى تقديرها كميّاً بالتفاعل مع الننهيدرين. والشكل التالي (صفحتى ١١١، ١١٢) يبين تتابع فصل الأحماض الأمينية.


من المعروف أن بعض الأحماض الأمينية تحمل شحنة سالبة (حامضية) والبعض الآخر يحمل شحنة موجبة (قاعدية) وأن درجة حموضة الوسط تلعب دوراً هاماً في اختلاف الشحنات على جزيئات الأحماض الأمينية- وفي حالة فصل الأحماض الأمينية بواسطة التبادل الأيوني يحدث ادمصاص عكسى Re-versible adsorption على جسم صلب Matrix مشحون (المتبادل الأيوني Ion exchanger) وتوجد بين الأحماض الأمينية والجسم الصلب اختلافات في قوة الإدمصاص حيث تستخلص Elute بعض الأحماض الأمينية بسرعة والبعض الآخر ببطء معتمدة على عدد الشحنات المتاحة في الأحماض الأمينية والجسم المختلف في نوع الشحنة.

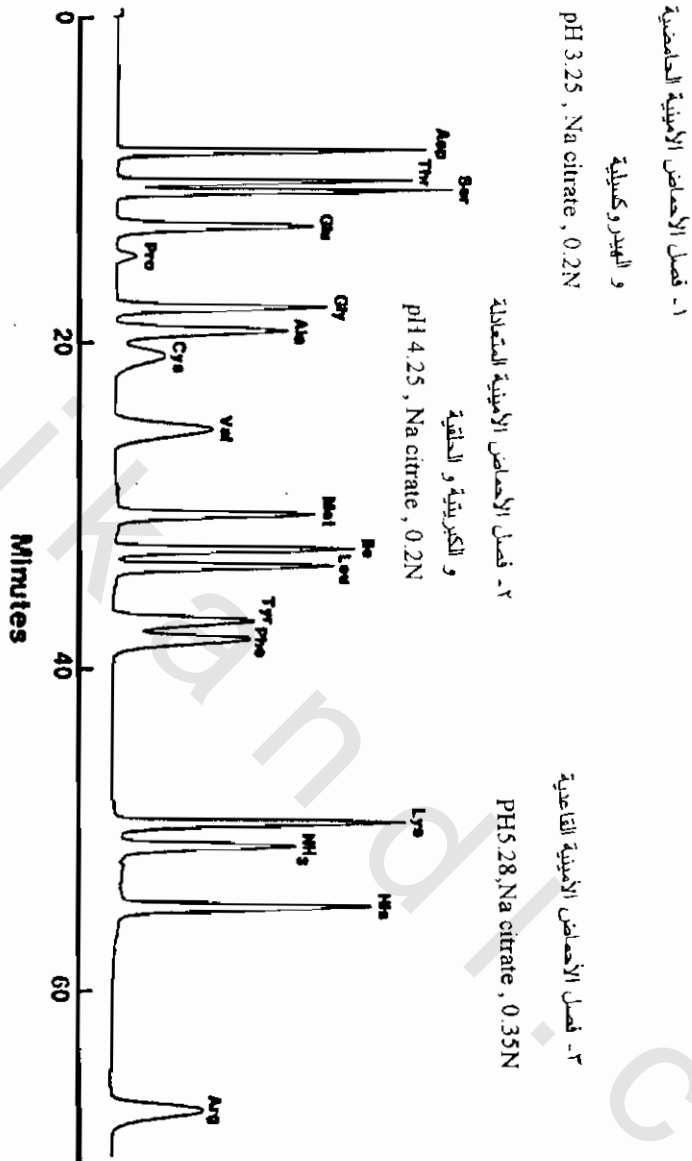

كروماتوجرام يبين تتابع فصل الأحماض الأمينية
الناجمة من التحليل المائي للبروتينات

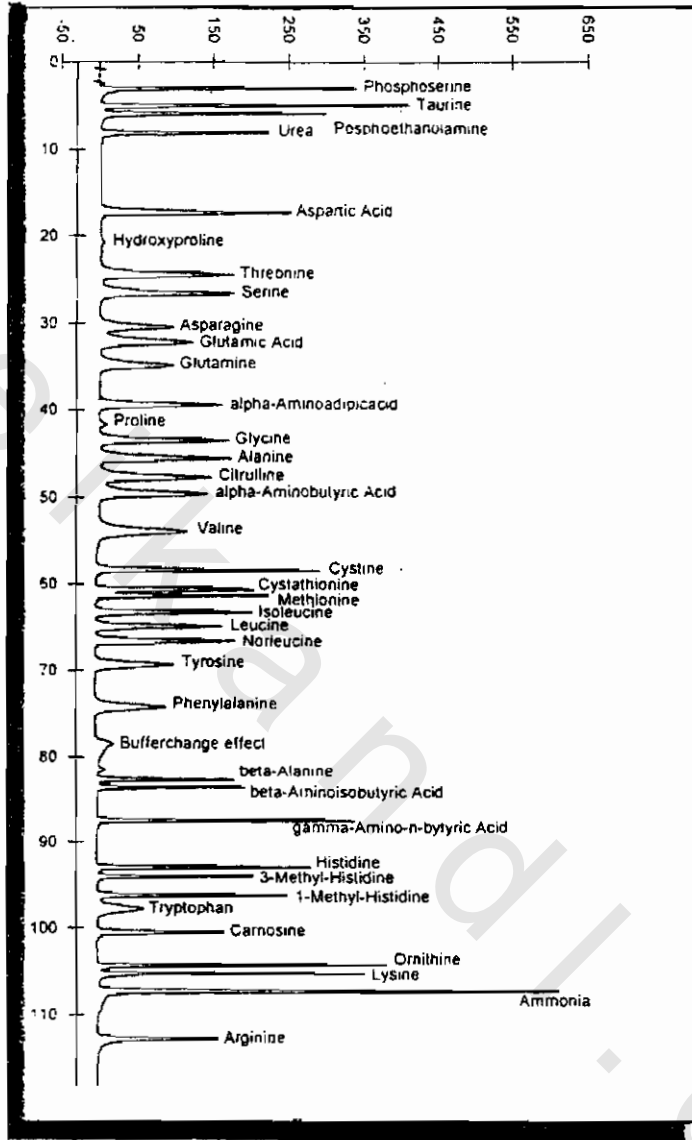

الكروماتوجرام التالي يبين تتابع فصل الأحماض الأمينية وبعض المركبات الأمينية الموجودة عادة في السوائل الحيوية باستخدام محاليل منظمة سترات الليثيوم ذات درجات حموضة مختلفة.

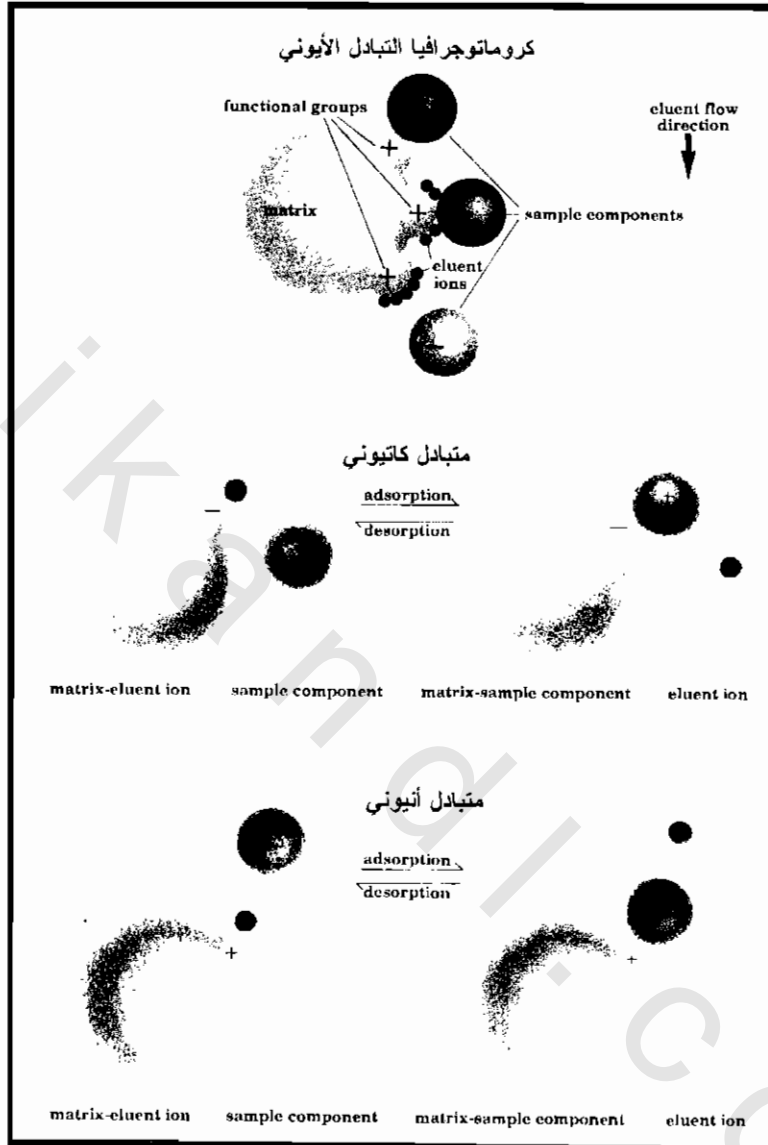

وفي حالة الإدمصاص العكسي Desorption فإن أيونات الطور المتحرك تتنافس مع الأحماض الأمينية في العينة المدمصة على الجسم الصلب المخالف في نوع الشحنة أو بمعنى آخر إن مكونات العينة المرتبطة على الجسم الصلب تتبادل مع أيونات الطور المتحرك الذي له نفس نوع الشحنة- تتم عملية الإدمصاص العكسي بالإستخلاص من نوع ايزوكراتيك Isocratic أى يستخدم طور متحرك ذو تركيب ثابت أثناء التحليل أو بطريقة أخرى أكثر شيوعاً وهي الإستخلاص المتدرج Gradient elution أى يتغير تركيب الطور المتحرك أثناء الفصل وهذه الطريقة لا غنى عنها Indispensable لفصل العينات الحيوية المعقدة .

والجدير بالذكر إن معظم المتبادلات الأيونية يمكن إستخدامها مرة أخرى Reusable بعملية الإسترجاع Regeneration أى التخلّص من الأيونات المرتبطة أى يجرى استبدالها لإستعادة Restore الظروف لفصل آخر. وتجرى عملية الإسترجاع بواسطة محاليل منظمة ذات تركيز عالى ويلي عملية الإسترجاع اتران للعمود Column equilibrium بإمرار المحلول المنظم الأول خلال العمود المسترجع .

ثامناً: جهاز تحليل الأحماض الأمينية Amino acid analyzer

تقدر الأحماض الأمينية وصفيّاً وكمياً باستخدام عمود يحتوى على راتنج التبادل الأيونى ويمرر خلاله الطور المتحرك حاملاً معه الأحماض الأمينية المفصولة كل على حدة ثم يتفاعل مع التنهايدرين ويتكون معقد لوني . والجهاز يعتمد أساساً على ضخ Pumped محاليل منظمة تختلف في درجة حموضتها أو قوتها الأيونية Ionic strength خلال عمود الراتنج Resin column المزود بترموستات لضبط درجة حرارته . وقد حدث تطور في الجهاز باستخدام راتنجات