


وفي حالة الإدمصاص العكسي Desorption فإن أيونات الطور المتحرك تتنافس مع الأحماض الأمينية في العينة المدمصة على الجسم الصلب المخالف في نوع الشحنة أو بمعنى آخر إن مكونات العينة المرتبطة على الجسم الصلب تتبادل مع أيونات الطور المتحرك الذي له نفس نوع الشحنة- تتم عملية الإدمصاص العكسي بالإستخلاص من نوع ايزوكراتيك Isocratic أى يستخدم طور متحرك ذو تركيب ثابت أثناء التحليل أو بطريقة أخرى أكثر شيوعاً وهي الإستخلاص المتدرج Gradient elution أى يتغير تركيب الطور المتحرك أثناء الفصل وهذه الطريقة لا غنى عنها Indispensable لفصل العينات الحيوية المعقدة .

والجدير بالذكر إن معظم المتبادلات الأيونية يمكن إستخدامها مرة أخرى Reusable بعملية الإسترجاع Regeneration أى التخلّص من الأيونات المرتبطة أى يجرى استبدالها لإستعادة Restore الظروف لفصل آخر. وتجرى عملية الإسترجاع بواسطة محاليل منظمة ذات تركيز عالى ويلي عملية الإسترجاع اتران للعمود Column equilibrium بإمرار المحلول المنظم الأول خلال العمود المسترجع .

ثامنا: جهاز تحليل الأحماض الأمينية Amino acid analyzer

تقدر الأحماض الأمينية وصفيّاً وكمياً باستخدام عمود يحتوى على راتنج التبادل الأيونى ويمرر خلاله الطور المتحرك حاملاً معه الأحماض الأمينية المفصولة كل على حدة ثم يتفاعل مع التنهايدرين ويتكون معقد لوني . والجهاز يعتمد أساساً على ضخ Pumped محاليل منظمة تختلف في درجة حموضتها أو قوتها الأيونية Ionic strength خلال عمود الراتنج Resin column المزود بترموستات لضبط درجة حرارته . وقد حدث تطور في الجهاز باستخدام راتنجات

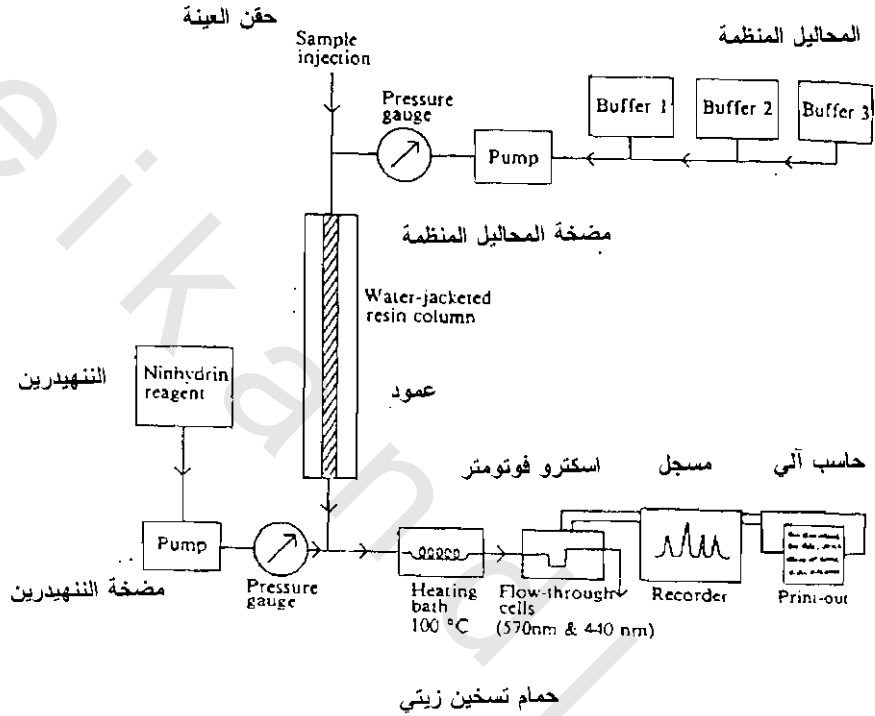

رسم تخطيطي لجهاز تحليل الأحماض الأمينية باستخدام النهيدرين للتقدير الكمي

ذات نوعية عالية ونظام للحقن الآلي، مع أنظمة للكشف ذات حساسية عالية. وهذا أدى إلى تقليل وقت التحليل من أيام إلى ساعات. بالإضافة إلى تقديرها كميًا حتى وإن كان تركيز الأحماض الأمينية أقل من 10^{-9} مولر.

الشكل التخطيطي التالي يبين أجزاء جهاز تحليل الأحماض الأمينية وهي:-

١- محاليل منظمة ذات درجة حموضة مختلفة عادة يستخدم ثلاث محاليل منظمة ١، ٢، ٣ لها درجة حموضة ٢٥، ٣، ٢٥، ٤، ٢٨، ٥ على التوالي وتعمل كطور متحرك لإحلال الأحماض الأمينية.

٢- مضخة لدفع المحاليل المنظمة داخل العمود Buffer pump.

٣- وسيلة لحقن العينة Sample injection.

٤- عمود راتنج وبه وسيلة لضبط وثبات درجة حرارة الفصل Resin column.

٥- مضخة لدفع الجوهـر الكشاف ننهيدرين Ninhydrin pump.

٦- حمام زيتي Reaction coil.

٧- خلية لتقدير الكثافة اللونية للمحلول Flow cell عند الطولين الموجين ٥٧٠ و ٤٤٠ نانوميتر.

٨- مسجل أو حاسب آلي Computer.

يتم الفصل داخل عمود يحتوى على مبادل كاتيوني قوى مثل (Sulphonated polystyrene resin) والذي له طبيعة تبادل أنيوني قوى $(-SO_3^-)$ ، وعند درجة الحموضة المنخفضة تحمل جميع الأحماض الأمينية شحنة موجبة وتنجذب إلى المجاميع السلفونية المحملة بالشحنة السالبة.

عند رفع درجة حموضة المحلول المنظم (الطور المتحرك) الذي يمر خلال العمود فإنه يحل Elute الأحماض الأمينية بمعدلات مختلفة حيث تنفصل الأحماض الأمينية بالتتابع على أساس قيم الـ PI لكل واحد منها. فعند درجة pH

٢,٥) درجة حموضة الوسط التي يبدأ عندها الفصل) نجد أن الأحماض الأمينية التي تحتوي على مجموعة حامضية (-COOH) زائدة في سلاسلها الجانبية لها تآلف قليل جداً مع المبادل وبالتالي هي أول الأحماض التي تخرج من العمود. عند نفس درجة حموضة الوسط المنخفضة (٢,٥) نجد أن الأحماض الأمينية التي تحتوي في سلاسلها الجانبية مجموعات قابلة للتأين والتي تحمل شحنة موجبة مثل الليسين والهستيدين ترتبط بقوة مع المبادل وتستخلص فقط من العمود عندما ترتفع درجة حموضة الوسط بدرجة كبيرة حيث تنخفض شحناتها الموجبة. يمتزج المحلول الخارج من العمود النيهيدرين (الجوهر الكشاف) ويسخن الخليط Effluent (محلول الحمض الأميني المفصول ومحلول النيهيدرين) على درجة ١٠٥° م حيث يظهر لون تقاس شدته عند الطولين الموجبين ٥٧٠ و ٤٤٠ نانوميتر.

ملخص لطريقة الفصل

- ١- يحقن خليط قياسي من الأحماض الأمينية وبعد إنتهاء التحليل يظهر تقرير يبين عدد الأحماض الأمينية القياسية R_f لكل حمض أميني ومساحات الـ peaks المقابلة للأحماض الأمينية.
- ٢- يزود الحاسب الآلي بالـ R_f لكل حامض اميني قياسي وتركيزه.
- ٣- يحسب ألياً معامل الاستجابة Response factor بقسمة التركيز ÷ المساحة لكل حامض أميني

$$\text{Amount} / \text{area} = \text{RF}$$

تحقن العينة - يقوم الحاسب الآلي اوتوماتيكيا بكتابة تقرير يبين فيه اسم الحمض الأميني (من المعلومات السابق تغذيته بها)، الـ R_f ، التركيز بالـ nM حيث تضرب المساحة في معامل الاستجابة لكل حمض أميني.

٤- يحول تركيز الحمض الأميني من nM الى ng بالضرب فى الوزن الجزيئى للحمض الأمينى.

٥- يحسب تركيز الحمض الأمينى على أساس % mg أو أى نوع آخر للدلالة على التركيز. يجب الأخذ فى الاعتبار أى تخفيف أجرى أثناء التحليل.

٨-١ ملاحظات عامة عن فصل الأحماض الأمينية

العمود Column

من المعروف أن قاعدة الـ Peak تتناسب طردياً مع الجذر التربيعى لطول العمود، فإن الأعمدة المستخدمة المصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ والتي طولها ٢٠ سم ومعبدة بمبادل كاتيونى قوى تعطى Peaks ذات قواعد ضيقة، وقيم عالية لارتفاع الـ Peak، أى تفصل بوضوح الأحماض الأمينية ذات التركيب الكيميائى المتقارب.

المحاليل المنظمة Buffers

يجب إمرار تيار من النيتروجين لمنع وجود فقائيع فى المحاليل المنظمة أثناء سريانها، ويجب أن يكون التركيب ودرجة حموضة الوسط مضبوطة إلى ٠.٠١، مول/ لتر و ٠.١ وحدة pH. وفى حالة الأجهزة التى يستخدم فيها عمود واحد Single column فإن تتابع الفصل يعتمد على سلسلة من المحاليل المنظمة والتي ترتفع فيها درجة حموضة الوسط عن درجة حموضة محلول البداية (٢، ٣). وتستخدم سترات صوديوم أو سترات الليثيوم مصحوبة بمنظف صناعى (Brij (35 ومادة مضادة للأكسدة (Thiodiglycol) ومادة حافظة (حامض الكابريليك) ويستخدم الاحلال المرحلى Stepwise elution وفيها تدفع المحاليل المنظمة خلال العمود لفترات مختلفة بالاعتماد على نوعية الأحماض الأمينية

المراد فصلها. والمحاليل المنظمة المستخدمة لها درجات pH ٣, ٢٥، ٤، ٢٥، ٢٨، ٥، ١٠ سواء بتركيزات مولارية ثابتة أو متغيرة لفصل الأحماض الأمينية الحمضية والمتعادلة والقاعدية.

درجة الحرارة Temperature

يجب أن تكون درجة حرارة المبادل داخل العمود ثابتة حتى يمكن التغلب على التغيرات في درجة الـ pH للمحاليل المنظمة وأيضا تأين الأحماض الأمينية. وبصفة عامة فإن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى سرعة الاحلال وإلى تغير نسبي في موضع الحمض الأميني الذي يجري احلاله وبالتالي يؤدي الى صعوبة تفسير النتائج. وعادة درجة الحرارة المختارة هي ٦٠° م ومع ذلك فان درجات الحرارة الأقل من ذلك تكون مطلوبة في بعض الأحيان لفصل الأحماض الأمينية المتقاربة في التركيب الكيميائي.

معدل السريان Column flow rate

يتطلب الفصل الناجح والحصول على نتائج متطابقة بتكرار التقدير أن يكون معدل سريان المحلول المنظم ثابتاً باستخدام ضغط ثابت أو مضخة دفع ثابتة. ويصمم هذا النوع من المضخات بأن تدفع المحاليل المنظمة بمعدل ثابت. ويعتمد اختيار معدل السريان على أساس نوع المبادل الكاتيوني وأبعاد العمود.

تحضير العينة Sample preparation

يختلف حجم العينة المحقون داخل العمود على حسب أنواع الأجهزة المتوافرة تجارياً. ففي حالة الأجهزة القديمة يتطلب حجم كبير من العينة (١ مل) نظراً لحساسيتها القليلة. وفي حالة الأجهزة الحديثة تحقن حجوم قليلة، عادة ٥٠ ميكرو لتر أو أقل. ويجب معرفة أن تحضير العينة المضبوط يؤدي إلى الحصول

على نتائج متطابقة وهذا يعتمد على طبيعة العينة ومكوناتها. ويجب أن يكون محلول العينة المحقون نظيفا خال من البروتينات والجزئيات الأخرى الكبيرة. وفي حالة الفشل للوصول إلى هذه المتطلبات فإنه يؤدي إلى إنسداد الفلتر Frit الموجود أعلى عمود المبادل الكاتيوني، وبالتالي يصبح من الضروري التخلص من المبادل وتنظيف وإعادة تعبئة العمود مرة أخرى، وهي خطوات شاقة. وبصفة عامة فإن العينات السائلة Liquid يلزم لها فقط عملية ترشيح أو طرد مركزي وإزالة البروتينات Deproteinization فإنه يلزم ترسيبها بواسطة حمض البكريك أو حمض سلفوساليسيليك أو باستخدام (الفرز الغشائي) Dialysis أو الترشيح الفوقى. وفي حالة العينات الصلبة Solid مثل الأنسجة النباتية أو الحيوانية أو الأطعمة فإنه يتطلب التجانس فى الاستخلاص والتخلص من البروتينات. وفي حالة الببتيدات والبروتينات فإنه يلزم إجراء التحليل المائى.

أولا: للحصول على الأحماض الأمينية الحرة.

يجب عند حقن العينة أن تكون مذابة فى محلول منظم ذو درجة حموضة ٢,٢ قبل بدأ فصل الأحماض الأمينية، وبعد عملية فصل واحلال جميع الأحماض الأمينية فإنه يلزم إجراء عملية إسترجاع Regeneration للمبادل الكاتيوني قبل حقن العينة التالية بإمرار محلول صودا كاوية ذو درجة حموضة ١٠. وفى الأجهزة الحديثة فإنه يتم الحقن آليا بعد تمام تحليل العينة السابقة وضخ المحلول المنظم من البداية للعينة التالية.

الكشف Detection

تعمل المضخة الثانية بالجهاز على ضخ معدل ثابت من الجوهر الكشاف ليقابل المحلول الخارج من العمود، وعند تمام التفاعل فإنه تقاس الكثافة اللونية باستخدام خلية Flow cell بواسطة جهاز تقدير الألوان أو قياس الفلورة Fluo-

rimeter. وعادة يستخدم الجوهر الكشاف النيهيدرين بعد أن يمر على ملف يسخن في حمام زيتي على درجة ١٠٠° م. ويتعين الامتصاص على طولين موجيين ٥٧٠ و ٤٤٠ نانوميتر للأحماض الأمينية والأيمينية على التوالي. يذاب النيهيدرين في ايثيلين جليكول (خال من البيروكسيدات) وأحادي ميثايل إيثر (ميثايل سيليلوسولف Methyl cellulose) باستخدام محلول منظم الخللات عند درجة حموضة ٥,٥. ويمرر تيار من النيتروجين أثناء تحضير الجوهر الكشاف للتخلص من الهواء، وتضاف كمية قليلة من مادة مختزلة مثل كلوريد القصيدروز أو كلوريد التيتانوس Titanous chloride بحيث تكفي لتكوين كمية معينة من النيهيدرين المختزل. ويكون لون الجوهر الكشاف ذو لون أصفر فاتح، ويجب تخزينه في زجاجة بنية وتحت ضغط من النيتروجين نظراً لأن النيهيدرين حساس للضوء والأكسجين.

يحتاج تفاعل النيهيدرين إلى حرارة ولذلك يمر خليط المحلول الخارج من العمود وجوهر النيهيدرين خلال ملف Reaction Coil من التفلون ذو قطر صغير (١ مم) ويظل على درجة حرارة ١٠٠° م في حمام زيتي. ويجب التأكد من أن السريان غير معاق، حيث أن الحرارة الزائدة تؤدي إلى ترسيب النيهيدرين في الملف ذو القطر الضيق مما يؤدي إلى إغلاق الجهاز تماماً Stoppage.

وهناك بعض الأجهزة الحديثة تعتمد على استخدام تفاعل الفيثالدهيد، وهو يشابه تقريباً تفاعل النيهيدرين في كثير من الأحوال. فمثلاً الجوهر الكشاف الفيثالدهيد ثابت وهو يذوب في الماء وبالتالي يمكن الاستغناء عن الكيماويات السامة مثل التي تستخدم في تحضير النيهيدرين، كما لا يحتاج الأمر إلى التخزين في جو من النيتروجين. ونظراً لأن تفاعل الفيثالدهيد يحدث بسرعة عند درجة حرارة الغرفة فإن الأمر لا يحتاج إلى التسخين على درجة ١٠٠° م في الحمام الزيتي وبالتالي يمكن التغلب على المشاكل المتعلقة بهذه النقطة. ونظراً

لزيادة الحساسية باستخدام تفاعل الفيثالدهيد، فإنه يمكن الكشف عن تركيزات من الأحماض الأمينية تصل إلى البيكومول (10⁻¹⁰-1⁻¹²).

٨-٢- تقدير الأحماض الأمينية كميًا Quantitation

تختلف كثافة اللون أو الفلورة الناتجة من مول واحد من الحمض الأميني اختلافاً قليلاً جداً تبعاً لنوعية الأحماض الأمينية. ولهذا ينتج عن حقن مخلوط من الأحماض الأمينية الذي يحتوى على تركيزات متساوية من كل حمض أميني (٢٠٠ نانومول/ مل) مساحات متساوية من الـ Peaks.

يجب استخدام مادة قياسية داخلية Internal standard لكل عملية تحليل، وهذه المادة هي عبارة عن حمض أميني غير موجود في العينة التي يجري تحليلها. فمثلاً عند تحليل عينة بلازما الدم يستخدم نورليوليسين أو ألفا أمينو بيتا جوانيدينو حمض البيوتيريك كمادة قياسية داخلية ويجب أن تضاف بتركيز معلوم إلى العينة قبل تجهيزها وتحليلها. وعند معرفة كمية المادة القياسية فإنه يمكن معرفة تركيز الأحماض الأمينية في العينة عن طريق معرفة مساحات الـ peaks للمادة القياسية والعينة. وفي هذه الطريقة يمكن التغلب على المشاكل التي تنشأ من فقد كمية من العينة أثناء التحضير. وكذلك اختلاف الكثافة اللونية للمحاليل المحضرة مثل النيهيدرين وكذلك التغيرات في ظروف التحليل.

ويمكن حقن خليط من الأحماض الأمينية معلوم تركيز كل حمض أميني كل على حدة (External standard) ومنه يمكن حساب كمية أى حمض أميني في العينة من الحسابات التالية:-

أولاً: استخدام محلول خليط الأحماض الأمينية القياسية
عند حقن كمية معلومة من هذا الخليط فإنه يمكن استنتاج حسابياً معامل
الاستجابة (RF) Response factor لكل حمض أميني بمعرفة تركيز الحمض
ومساحة الـ peak الخاص به .

معامل الاستجابة (RF) = التركيز ÷ مساحة الـ peak

ثانياً: يعرف تركيز الحامض الأميني بعد حقن العينة من المعادله التاليه:-

التركيز = مساحة الـ peak x معامل الاستجابة .